


KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dla województwa śląskiego

Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze; ul 3 Maja 13-15
Tel +48 323704586; fax +48323704593, e-mail anestezjologia@szpital.zabrze.pl

Zabrze, 03.03.2014r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
p.o. Dyrektora
Barbara Bulanowska

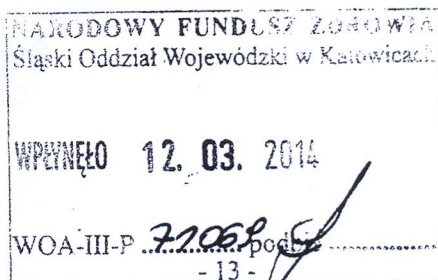

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na Pani pismo znak: WSOZ-II-STM-074-2/317/jl/2014 podaję co następuje:

Warunki wykonywania znieczulenia w jakimkolwiek podmiocie precyzuje § 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Standardy oraz wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska znieczulenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się w:

- 1) ambulatorium lub przedsiębiorstwie, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne,
- 2) pomieszczeniach, w których jest wykonywana praktyka zawodowa – w których są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji.

W treści Zał. Nr 1 do powyższego rozporządzenia zawarte są następujące dane:

A. Wyposażenie stanowiska znieczulenia

- 1) aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym; aparaturę anestezjologiczną stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc wyposaża się także w:

- a) alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,
- b) alarm rozłączenia w układzie oddechowym,
- c) urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,
- d) urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych;
- 2) worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe;
- 3) źródło tlenu, powietrza i próżni;
- 4) urządzenie do ssania;
- 5) zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami;
- 6) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji – co najmniej 1 na zespół połączonych ze sobą stanowisk znieczulenia lub wyodrębnioną salę operacyjną;
- 7) wyciąg gazów anestetycznych;
- 8) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;
- 9) znormalizowany stolik (wózek) anestezyjologiczny;
- 10) źródło światła;
- 11) sprzęt do dożylnego podawania leków;
- 12) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;
- 13) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;
- 14) termometr;
- 15) pulsoksymetr;
- 16) monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych;
- 17) kardiomonitor;
- 18) kapnometr;
- 19) monitor zwiótczenia mięśniowego – 1 na stanowisko znieczulenia;
- 20) monitor gazów anestetycznych – 1 na stanowisko znieczulenia;
- 21) sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;
- 22) urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych;
- 23) urządzenie do ogrzewania pacjenta – co najmniej 1 na 3 stanowiska znieczulenia;
- 24) sprzęt do szybkich przetoczeń płynów;
- 25) sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów;
- 26) co najmniej 3 pompy infuzyjne.

Wyposażenie sali nadzoru poznieczuleniowego lub stanowiska nadzoru poznieczuleniowego

- 1) wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;
- 2) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji;
- 3) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % – co najmniej 1 na salę nadzoru poznieczuleniowego;
- 4) stanowiska nadzoru poznieczuleniowego:
 - a) źródło tlenu, powietrza i próżni,

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dla województwa śląskiego

Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze; ul 3 Maja 13-15
Tel +48 323704586; fax +48323704593, e-mail anestezjologia@szpital.zabrze.pl

-
- b) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
 - c) monitor EKG,
 - d) pulsoksymetr,
 - e) termometr;
 - 5) elektryczne urządzenia do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru
pożniczeniowego.

Łączę wyrazy szacunku i pozostaję do dyspozycji.

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii
Hanna Misiołek
Prof. dr hab. med. Hanna Misiołek